


ACHTUNG:

Der LernMaster ist ein radionisches Gerät und kein Medizinprodukt im Sinne der Medizinprodukterichtlinie. Die Vitalisierung (radionische Bewellung) unterstützt ausschließlich nur den Lernprozess und die Vitalisierung!

- Der LernMaster ersetzt grundsätzlich keinesfalls eine ärztliche Diagnose und Behandlung!
- Das Gerät darf nicht beim Autofahren benutzt werden!

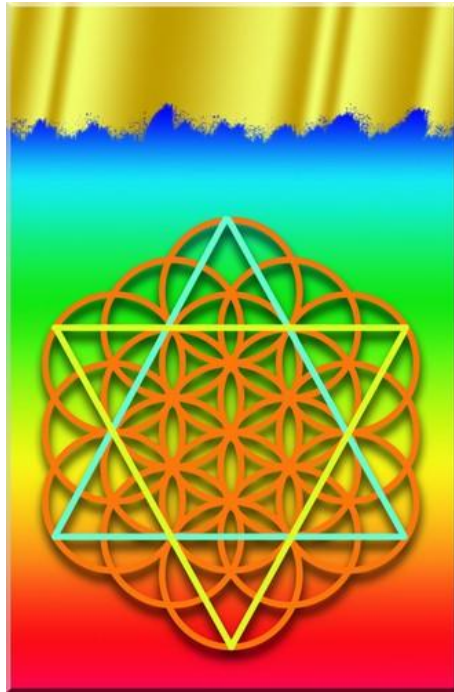

Disconder – LernMaster und Bewusstseinstrainer

Die Software DISCONDER wird nur im Zusammenhang mit dem *LernMaster und Massagegerät* vertrieben.

Copyright © 2007 – 2014 Walter Thurner

Alte Allee 78a


81245 München

www.walter-thurner.de / Quantentherapie

Dieses Programm ist urheberrechtlich geschützt. Der Vertrieb dieser Software bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung, unbefugte Vervielfältigung ist strafbar.


Tel. +49 / 089 / 5803357 iba.thurner@t-online.de

www.walter-thurner.de



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verhaltensmuster umprogrammieren	3
DIDCONDER Software	
Installation	4
Automatischer Bedienungsablauf	5
Manueller Bedienungsablauf	9
Lernmaster und Bewusstseinstrainer	
Allergie	14
Technische Eigenschaften	14
Certifikat	15
Sicherheitshinweise	16
Player Bedienung	17



LernMaster - Verhaltensmuster umprogrammieren-

Der LernMaster kommuniziert direkt mit dem Unterbewusstsein.

Jeder Gedanke erschafft, wenn er wiederholt wird, unsere Wirklichkeit, unser Universum um uns herum.

Über einprogrammierte Verhaltensmuster, die aus alten Erfahrungen und Erlebnissen resultieren, entstehen negative Gedankenmuster, die in uns Programme erzeugt haben, die unseren Erfolg verhindern.

Mit dem LearnMaster können neue Glaubenssätze (Affirmationen) in Ihr Bewusstseinsfeld eingegeben werden. Somit kann durch diese Informationsübertragung eine dauerhafte Umprogrammierung eines Gedankenmusters erfolgen.

Dieser Vorgang der Beschallung geschieht über das weiße Rauschen, und wird auf das biologische System der ausgewählten Person übertragen.

Die Informationen werden wie Radiowellen für den Menschen nicht spürbar in das morphogenetische Feld eingetragen (das Feld der unbegrenzten Möglichkeit), womit die neuen Glaubenssätze in neuer Form auf das biologische Feld der Person einwirkend und zur Neuprogrammierung führen.

Durch die Wiederholung der selbst aufgesprochenen Affirmationen gelangen die gewünschten Neuprogrammierungen solange ins Bewusstseinsfeld, bis die ursprünglichen Verhaltensmuster überlagert werden.

Selbst aufgesprochene neue Glaubenssätze stellen die tiefstgreifendste Möglichkeit dar, um neue Verhaltensprogramme ins Psychische-System aufzunehmen.

Eingegeben werden können auch Frequenzen die sich auf verschiedene körperliche Symptome harmonisierend auswirken.


Im Frequenzprogramm befinden sich umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten für Gesundheitsblockaden.

Die Programme können einfach vom Computer auf den LearnMaster übertragen werden.

Durch die ständige Wiederholung der harmonisierenden Frequenzen werden dem Körper Informationen eingegeben, wodurch das körpereigene System einen Impuls bekommt, was die Person wieder zur inneren Mitte kommen lässt.

Übertragen werden können auch Heilpflanzen und Bachblüten.

Der Vorgang geschieht lediglich über den Weg der Übertragung der Information auf elektro- magnetischem Weg direkt in das biologische System hinein.



Disconder Software

Systemvoraussetzungen:

Windows 2000: SP 4
Windows XP: SP 2 und eventuell bei alten Systemen
WindowsInstaller-KB893803-v..
Vista: keine Systemvoraussetzungen
System 7: keine Systemvoraussetzungen
System 8: keine Systemvoraussetzungen



Installation der Disconder-Software:

Systemvoraussetzungen:

- Windows 2000, mindestens SP4
- Windows XP , mindestens SP2
- sowie den Microsoft: Windows Installer 2.0 oder höher
- VISTA
- System 7
- System8


Vorgehensweise:


- Legen Sie die Installations-CD „Disconder“ in das CD-ROM – Laufwerk ein.
- Klicken Sie auf der CD die Datei „SetupDisconder.exe“ an. Die Installation überprüft zunächst, ob die Microsoft Komponente „.NET“ bereits auf Ihrem Computer installiert ist. Falls nein wird diese zunächst installiert. Sollte diese Installation misslingen, fehlt auf Ihrem Computer der Windows Installer 2.0 oder höher. Diesen können Sie von den Microsoft-Support-Seiten im Internet downloaden, oder wenden Sie sich an Ihren PC-Service-Support (sind auch auf der DVD unter „Support/Service“ geladen).
- Wählen Sie ein Installationsverzeichnis: z.B. „C:\“ Falls das Verzeichnis nicht existiert, können Sie es so anlegen:

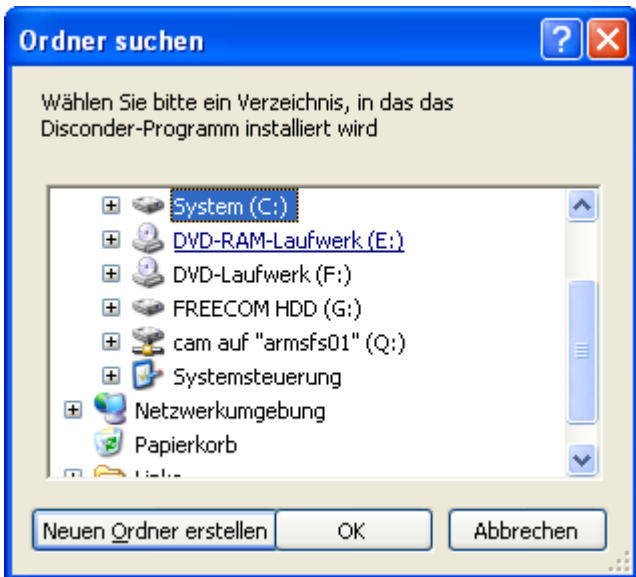

Klicken Sie das gewünschte Laufwerk und anschließend das Verzeichnis an, in dem das Disconder-Verzeichnis angelegt werden soll und wählen Sie dann die Option „Neuen Ordner erstellen“. Tippen Sie „Disconder“ und klicken Sie anschließend „OK“.

- Das Ende der Installation wird angezeigt mit:

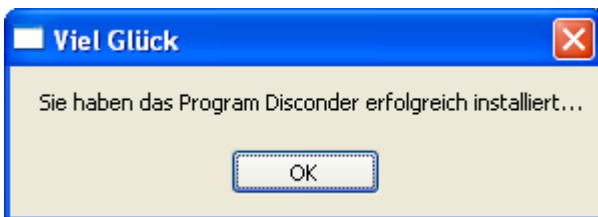


Sie finden auf Ihrem Desktop nun ein Icon für den Start: , sowie in Ihrem Programm-Menü einen Eintrag „Disconder“ mit den Optionen : „DOKU“ und „Start.“


DISCONDER Software Bedienungsablauf für autom. Ablauf.

Disconder mit automatischem Ablauf ermöglicht in nur 7 Bedienungsschritten eine kompletten Erstellung von individueller und persönlicher Informationsbehandlung. Die Ergebnisse der Informationsbehandlung sind für folgende Behandlungsmethoden wie


- Bewusstseinstrainer und Lernmaster
- Schallbehandlung
- IR-Licht
- Kozyrevspiegel und
- Skalar matten einsetzbar.




1. Automatisch anwählen

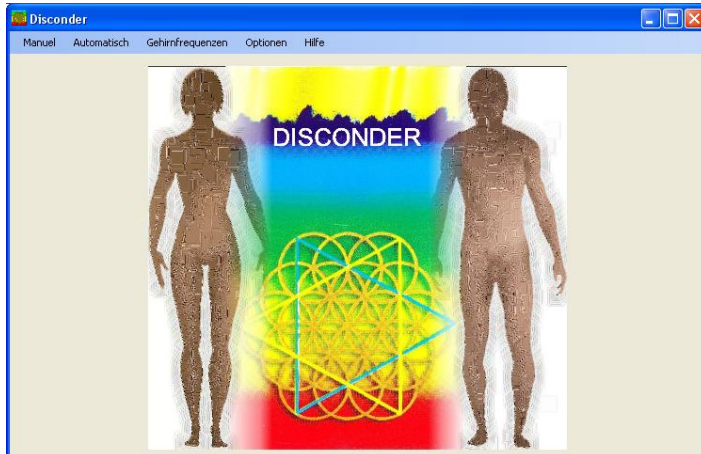


2. Das eigene Personenfoto auswählen (vorher ein Foto machen)

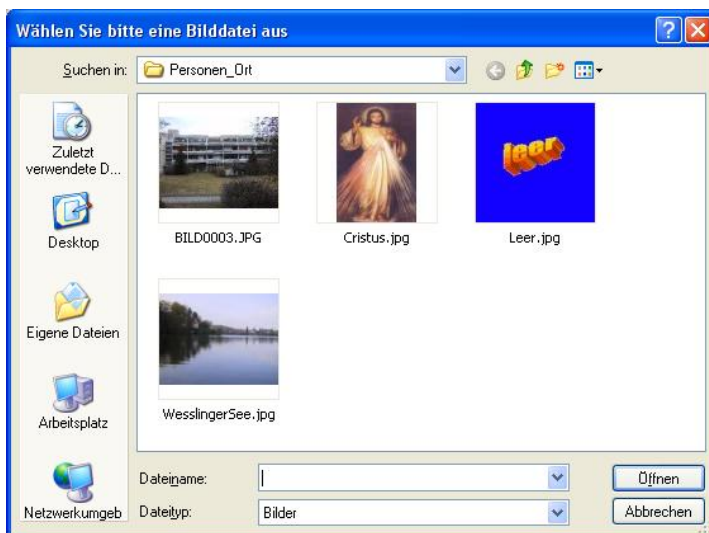




3. Individuelle Fragen anwählen

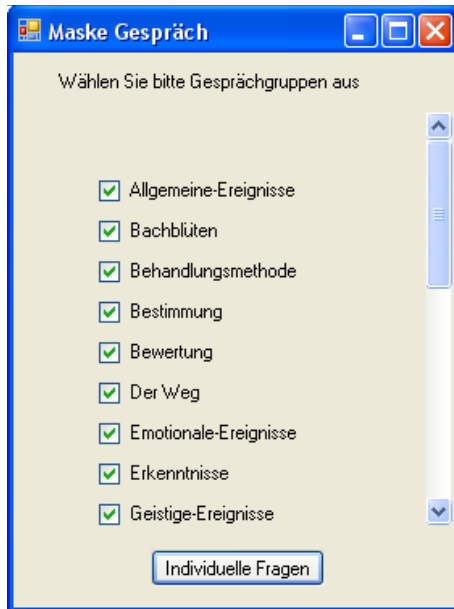

In der Gesprächsmaske stehen 24 Gruppen zur Auswahl. Es ist den Anwender überlassen, ob alle Informationsgruppen zur Bearbeitung erwünscht sind. Mit den Auswahlhäkchen kann der Bearbeitungsumfang gesteuert werden.


Die Eintragung ist kein muss.

4. Start Analyse anwählen

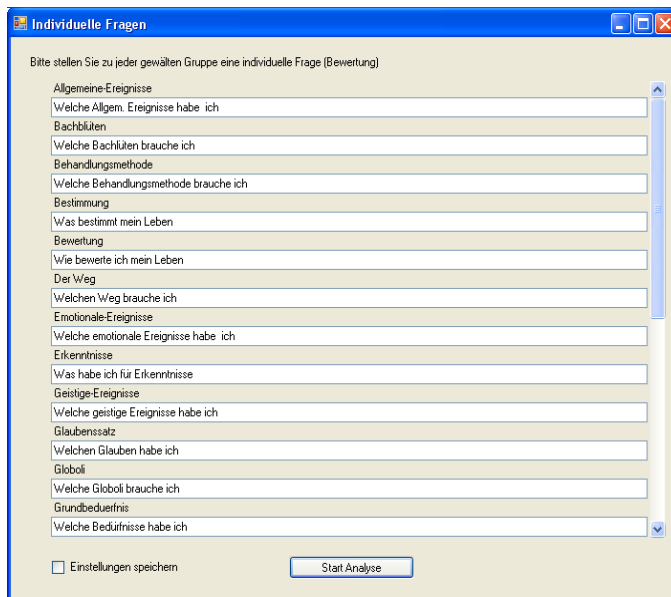

Mit den Individuellen Fragen kann der Anwender mit gezielten Anliegen oder Fragen in die Auswertung einwirken.

Die Eintragung ist kein muss.



5. Individuelle Fragen anwählen

Wählen Sie bitte Gesprächsgruppen aus

- Allg. Symtome_1
- Allg. Symtome_2
- Melodien
- Symtome nach Reif
- Vitalfrequenzen
- Zahlen

Individuelle Fragen

Mit der Menge der Gruppenauswahl wird die Behandlungszeit gesteuert. Alle 6 Gruppen ausgewählt ergibt eine Behandlungszeit von 5 Stunden. Behandlungen von 5 Stunden sind aber nur mit dem Bewusstseinstrainer oder das laden von Globuli sinnvoll. Für Behandlungen mit IR-Licht, Schall oder Skalar-Matten wird eine Auswahl von nur einer Gruppe empfohlen.

Die Eintragung ist kein muss.

6. Start Analyse anwählen

Bitte stellen Sie zu jeder gewählten Gruppe eine individuelle Frage (Bewertung)

Allg. Symtome_1
Welche Frequenz brauche ich für den Körper und Geist zur Norm

Allg. Symtome_2
Welche Frequenz brauche ich den Körper und Geist zur Norm

Melodien
Welche Frequenz brauche ich den Körper und Geist zur Norm

Symtome nach Reif
Welche Frequenz brauche ich den Körper und Geist zur Norm

Vitalfrequenzen
Welche Frequenz brauche ich den Körper und Geist zur Norm


Zahlen
Welche Frequenz brauche ich den Körper und Geist zur Norm

Einstellungen speichern


Start Analyse

Mit den Individuellen Fragen kann der Anwender wie beim Gespräch mit gezielten Anliegen oder Fragen in die Auswertung der Frequenzen einwirken.

Die Eintragung ist kein muss.



7. Mit Frequenzangabe die Informationen auf den externen Player übertragen

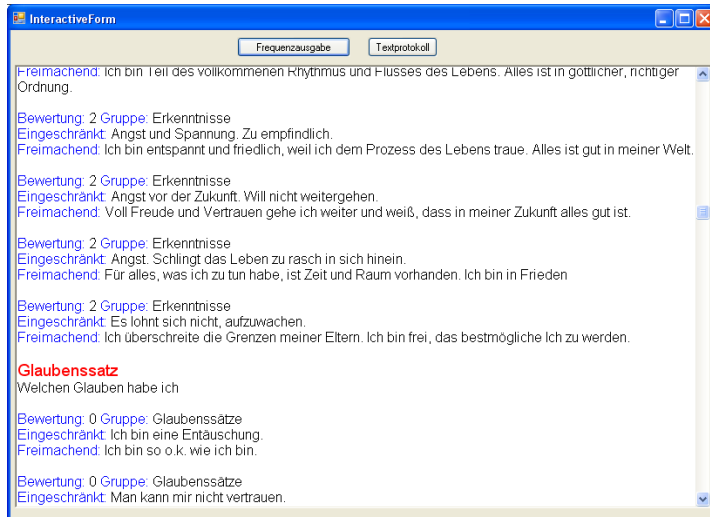

Mit der Taste „**Frequenzangabe**“ wird direkt per „HOP und DROP“ die vom DISCONDER erstellte Informationsdatei (WAV-Datei) auf den externen Player zu Behandlung übertragen. Außer den Einschaltknopf sind am Player keine weiteren Bedienungen notwendig.


Mit der Taste „**Textprotokoll**“ kann eine Inhaltsliste über die erstellte Informationsbehandlung am Drucker ausgelistet werden. Den Aufbau der Liste entnehmen Sie aus der Beschreibung „DISCONDER Ursachenerkennung“ Seite 30 und DISCONDER Frequenzen Seite 18.

DISCONDER Software Bedienungsablauf für manuellen Ablauf.

Wenn zu den autom. Ablauf noch weitere spezielle Informationsverarbeitungen notwendig sind, können die vom Anwender gewünschten Vorgänge manuell erstellt und in die Anwendungsdatei am Player übertragen werden. Neben der autom. Anwendung sind auch zusätzliche manuelle Anwendungen gleichzeitig möglich.

Aus der WAV – Datei:

Bearbeitung von bereits vorhandenen WAV – Dateien. Das WAVE-Dateiformat wurde von Microsoft und IBM zur verlustfreien



Speicherung von Audiodateien entwickelt. Aufgrund der großen Dateigröße wird dieses Format im kommerziellen Umfeld heute kaum verwendet. Es eignet sich jedoch wegen seines unverfälschten und ungekürzten Aufbaus sehr gut zum Modulieren, Wobbeln und Mischen und die Ausgabe über den Audioport ist als Funktionsgenerator nutzbar. Alle anderen Musikformate sind für die Verarbeitung mit dem Disconder nicht brauchbar. Nach der Auswahl wird ein Browser – Menü vorgelegt. In diesem Browser- Menü wählen Sie ein Verzeichnis aus und danach die zu verarbeitende WAV - Datei.

Aus einem WAV – Verzeichnis

Bearbeitung von bereits Vorhandenen Verzeichnissen mit WAV – Dateien. Wenn mehrere WAV – Dateien zu bearbeiten sind, könne alle in ein eigens kreierte Verzeichnis gelegt und zeitsparen alle auf einmal bearbeitet werden.

Nach der Auswahl wird ein Browser – Menü vorgelegt. In diesem Browser- Menü wählen Sie Ihr vorbereitetes Verzeichnis aus und danach werden alle im Verzeichnis liegende WAV – Dateien bearbeitet.

Aus einer MP3 – Datei:

Die meisten Musik- und Hörsysteme werden am Markt in MP3 – Dateien angeboten. MP3 – Dateien sind wegen der extremen Kürzung für eine technische Weiterbearbeitung nicht geeignet. Alles nicht Hörbare wird im MP3-Format entfernt, aber gerade auf die nichthörbaren Bereiche kommt es im Disconder im Besonderen an. Um auch MP3 – Dateien zu verarbeiten, werden alle MP3 – Dateien vom Disconder erst in eine WAV - Datei gewandelt.


Nach der Auswahl wird ein Browser – Menü vorgelegt. In diesem Browser- Menü wählen Sie ein Verzeichnis mit MP3 –Dateien aus und danach die zu verarbeitende MP3 - Datei.

Vordefinierte Melodien und Klänge:

Vordefinierte Melodien und Klänge sind kurze Musikstücke aus mehreren Frequenzen. Diese Melodien werden in 2 Hauptgruppen aufgeteilt, in Melodien die aus Bildern, und in Melodien die aus Instrumenten generiert wurden. Folgende Melodien wurden aus Bildern generiert

- Organe
- Bachblüten
- Farben
- Globuli
- Pflanzen
- Edelsteine

Die Bilder sind Fotos die in einem speziellen Verfahren vertont wurden. Anschließend wurde dieser Ton mit einer original



meditativen tibetischen Klangschale moduliert und in den ausgewiesenen Verzeichnissen zu Auswahl abgelegt.

Melodien aus Instrumenten sind

- Chakren
- Nährstoffe
- Klangschalen

In einem speziellen Verfahren wurden Resonanzen zu den genannten Medien aufgebaut. Anschließend wurden diese Resonanztöne mit einer original meditativen tibetischen Klangschale moduliert und in den ausgewiesenen Verzeichnissen zur Auswahl abgelegt.

Aufgerufen werden diese Melodiegruppen durch Auswahl der Gruppen und anschließend durch Auswahl der Melodien in den Gruppen.

Tonfrequenzen generieren:

Tonfrequenzen sind in 3 Hauptgruppen aufgeteilt

- Tonleiter,
- Fest definierte Frequenzen und
- manuelle Eingabe.


Die Bearbeitung der **Tonleiter** bedarf Grundkenntnisse in der Musik und Grundkenntnisse des natürlichen logarithmischen Aufbaus in der Zahl „e“ nach Euler. Wegen der umfangreichen Ausführung dieser Zusammenhänge wird an dieser Stelle auf die weitere Erläuterung verzichtet und ausdrücklich auf die Hilfebeschreibung verwiesen. Da viele Vorteile durch diese Anwendung beobachtet wurden, lohnt sich die Einarbeitung in diese Grundkenntnisse.

Die Bearbeitung der **fest definierten Frequenzen** resultieren aus Erfahrungen des US – Amerikaners Rive und vieler Heilpraktiker.

Manuell kann jede beliebige Frequenz eingegeben und angewendet werden.

Alle 3 Eingabemöglichkeiten können als Grundton oder als Quinte (harmonisch) betrieben werden. Bei Angabe der Quinte wird die entsprechende Frequenz automatisch berechnet. Mit der Dauer kann die Länge der Wiedergabe festgelegt werden. Es ist wichtig darauf zu achten, dass vor allem die „**pathologischen Frequenzen**“ aus mehreren Frequenzen (bis zu 20) bestehen. Wenn die Dauer erhöht wird, gilt das für jede einzelne Frequenz und es kommt unter Umständen zu ungewollt langen Laufzeiten. Die Lautstärke ist optimal eingestellt und sollte nur bei gezielten Anwendungen verändert werden. Über „Generieren“ wird die Auswahl abgeschlossen.

Aufgerufen werden diese Frequenzgruppen durch Auswahl der Gruppen und anschließend durch Auswahl der Frequenzen in den Gruppen. Bei Manuell ist keine Gruppenangabe erforderlich.



Ton / Sprache aufnehmen:

Ton / Sprache ist der Rekorder in diesem System. Es dient hauptsächlich zum Aufnehmen von Affirmationen, Behebung von Konflikten, Ängsten, Glaubenssätze sowie Beeinflussung durch Erlebnisse usw. Der Klient bespricht mit seiner eigenen Sprache eine Rekorder – Datei.

Mit der Wiederholung kann die Häufigkeit der Wiedergabe festgelegt werden.

Die Aufnahme wird über „**START**“ begonnen und über „**STOP**“ beendet. Über „**Start – Wiedergeben**“ kann die Aufnahme vor der Weiterverarbeitung kontrolliert werden.

Ausgabe erzeugen:

Mit **Ausgabe erzeugen** wird die Ausgabeart (ein oder zwei Kanal), die Gehirnfrequenz und die zu verarbeitende WAV- Datei angezeigt. Mit der Wiederholung kann die Häufigkeit der Wiedergabe festgelegt werden. Mit der „Ausgabedatei“ wird das Verzeichnis und der Dateiname für die Ausgabe angegeben. Über „**MIXEN**“ wird die Verarbeitung und das Anlegen der Datei gestartet.

Manuele - Schnellanleitung:

Schritt 1: Gehirnfrequenz auf Alpha oder Theta einstellen

- Weiter
(Alpha: Lernen, Theta: Meditation, tiefes Lernen)

Schritt 2: Eingabequelle auswählen und

Schritt 3 Ausgabe erzeugen:

- Weiter

-vordefinierte Melodien und Klänge: Auswahl: Heilpflanzen, Bachblüten, Chakren, Farben, Globoli, Klangschalen, Nährstoffe, Planeten, Steine

Wiederholungen: z. B. 108

Ausgabedatei: z. B. Test.wav -Mixen

-Tonfrequenz generieren: Vitalisierung über Grundfrequenz:

Vitalisierung von Organen A-Z

Auswahl: nur Grundton – Generieren


Wiederholungen z. B. 108

Ausgabedatei: z. B. Test.wav - Mixen

-Ton/Sprache aufnehmen: Sprache aufnehmen über Mikrofon (an den Computer anschließen) –Start Aufnahme – Stop – Übernehmen

Wiederholungen: z. B. 108

Ausgabedatei wählen z. B. Test.wav -Mixen



Neu generierte Datei über ein USBN-Kabel auf den LearnMaster (Music) übertragen.

Disconder Bedienungs Anleitung:
siehe auch in der „Hilfe - Beschreibung“ im Disconder Programm.

Inhaltsbeschreibung und Bedienanleitung der Disconder Hilfe

Anwendungsmöglichkeiten

Sprache:

Affirmationen/ Mentaltraining:

Gehirnwellen-Frequenzen:

Musiktitel:

Frequenztherapie

Die Quinte

Melodien und Klänge

Phasenverschiebung

Verhältnisse im goldenen Schnitt

Die Energiemeridiane im menschlichen Körper:

Systemvoraussetzungen:

Vorgehensweise:

Bedienung des Disconder-Programms:

Schritt 1: Auswahl einer Gehirnfrequenz:

Schritt 2: Eingabequelle auswählen

Auswahl einer WAV – Datei:

Auswahl einer MP3-Datei:

Auswahl aus bestehenden Melodien und Klängen:

Auswahl über Tonfrequenzgenerierung

Auswahl über Ton / Sprach-Aufnahme

Schritt 3: Ausgabedatei erzeugen:

Der Lernmaster

Bei jeder Anwendung des LearnMasters:

Hörprogramme die nicht als Quelldatei erkannt werden

Löschen von Titeln:

Beschreibung des Gerätes auf der Sensorseite:

Batterie laden

Laden über den Netzstecker:

Laden über den Computer

Musiktitel hören

Sprachen lernen:

Meditation:

Affirmation:

Sicherheitshinweise

Technische Eigenschaften:

Ergänzungen und Tipps

FreeRip Umwandlungsprogramm

Titel am LearnMaster ordnen:


Anwendung vom LearnMaster mit Kopfhörer:

Einstellen der Wiederholungsfunktion für einen speziellen Titel

Allergie

Schwingungstherapie mit dem Lernmaster.

Musiktherapie



Klangtherapie
Klangschalentherapie
Frequenztherapie
Bioresonanz
Tontherapie
Infrafrequenzen

LernMaster und Bewusstseinstrainer

Allergie

Die Kontaktplatten auf der Rückseite des Gerätes sind aus Edelmetallen, also aus einem Material das die Biologie des Körpers nicht kennt. Sollten trotzdem allergische Erscheinungen auf der Haut auftreten, müssen die kleinen Kontaktblättchen mit einem Wundpflaster abgeklebt werden. Die kleinen Kontaktplättchen sind für die Vitalisierung oder den Lernerfolg nicht entscheidend. Die kleinen Kontaktflächen gleichen energetische Energien aus, die in unserer modernen Umwelt z.B. durch Handy verloren gehen.

Treten danach weiterhin noch allergische Erscheinungen auf, so ist die Verwendung des Lernmasters unverzüglich einzustellen.

Technisch Eigenschaften der Elektroden:

Stromversorgung von 2 bis 3,5 V


Ausgangselektroden auf der Rückseite des Players:

Audio Kontakte (große Kontaktflächen)

Spannung DC 0,0 V, AC 20 mV
Strom Kurzschlußstrom bis AC 0,01 mA
Stromführung über die Haut bis AC 0,0001 mA
Ausgangsimpedanz 20KOhm
Frequenzen: Audibereich von 1Hz bis 20 KHz Analog

Vitalisierungskontakte (kleine Kontaktflächen)

Spannung DC 0,0 V AC 0,01V
Strom Kurzschlußstrom bis AC 0,3 mA
Stromführung über die Haut bis AC 0,001 mA
Ausgangsimpedanz 10KOhm
Frequenzen: von 100 KHz bis 1 MHz Analog



C€ Certifikat

Player C€ Nr.5256

DIN EN 6060_1-1-2, VDE 0750-1-2-2007-12 Medizinische elektrische Geräte- Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit – Anforderungen und Prüfungen (IEC 60601-1-2-2007, modifiziert); EN 60601-1-2:2007. Ausgestellt am 6.03.2014 von Schwille Elektronik.

Stromversorgung (Ladegerät) C€ Nr. 20130717


Report Reference E143128-A86-UL

Issue Date 2013-July-17










Issued to FRIWO GERÄTEBAU GMBH


Von –Liebing-Str . 11

48346 Ostbevern Germany



Sicherheitshinweise

	Das Gerät stellt für den Anwender keinerlei Gefahr dar, da eine innere Stromquelle mit niedriger Spannung (3V) verwendet wird.
	Das Gerät darf nicht an Anwender benutzt werden, bei denen ein elektronischer Apparat (z.B. Herzschrittmacher) implantiert wurde. Ebenso darf das Gerät nicht bei Personen angewendet werden, die an Unverträglichkeiten gegenüber elektrischen Strom leiden.
	Es ist verboten, das Gerät in der Direktprojektion des Herzens vom vorne zu verwenden.
	Während der Anwendung darf die Person nicht an ein wie auch immer geratedes Hochfrequenzstromgerät angeschlossen werden. (Verbrennungsgefahr) Außerdem ist in einem solchen Fall die Zerstörung des Lernmasters möglich.
	Wird in der Nähe eine therapeutische Kurzwellen-, Mikrowellenvorrichtung oder Handy in Betrieb genommen, kann dies beim Lernmaster zur Instabilität der Ausgangsparameter führen.
	Das Gerät enthält zerbrechliche Elemente. Schützen Sie den Lernmaster vor Stößen.
	Der Lernmaster ist nicht wasserdicht, schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.
	Alle Funktionsstörungen werden durch den Hersteller behoben.
	Entsorgung: Sämtliche Verpackungsmaterialien sind für die Umwelt unschädlich und können wiederverwendet werden. Der Lernmaster ist ein elektronisches Gerät und muss in den Elektronikschrott.
Audio-Stecker USB-Stecker	Während der Anwendung ist es nicht erlaubt, Elektrische- Geräte welcher Art auch immer am Player anzuschließen, Stromschlaggefahr.



Player Bedienung

Audioanschluss

Anschlussmöglichkeiten für Kopfhörer mit Lautstärkenregler. Am Player dürfen keine weiteren externen Elektrischen -Geräte (Audiogeräte) während der Anwendung angeschlossen werden, **STROMSCHLAGGEFAHR**. Erlaubt sind nur Kopfhörer oder Ohrmuscheln.

Kontrolllampen

1. Kontrolllampe Batterie - Ladebetrieb

Wenn der Player an einem Ladestecker angeschlossen wird leuchtet die Kontrolllampe während des Ladebetriebes rot. Kein Licht während des Ladebetriebes bedeutet, die Batterie ist voll. Am Player dürfen keine externen Elektrischen -Geräte (Batterieladebetrieb) während der Anwendung angeschlossen werden, **STROMSCHLAGGEFAHR**.

2. Kontrolllampe Betriebszustand des Players

- Leuchtet die Betriebsleuchte nach einschalten rot, so ist der Player nicht im Betrieb. Störung, eventuell ist die Magnetkarte defekt oder nicht gesteckt.
- Leuchtet die Betriebslampe grün/rot ist der Player im Betrieb.
- Leuchte die Betriebslampe nicht, so ist der Akku leer.

EIN - AUS Schalten

EIN Die Auslösetaste 1. Taste von links drücken

AUS Die Auslösetaste 2. Taste von links drücken

Datenübertragung

- Über die Magnetkarte


Die Magnetkarte kann auch extern geladen werden. Mitgelieferte Behandlungsvorschläge in den Magnetkartenleser einsetzen. Ist eine Karte bereits gesteckt, wird sie kurz angetippt und die Karte springt von alleine heraus

- Über USB Anschluss

Der Mp3 Player kann zur Übertragung der Daten von einem PC wie ein Stick behandelt werden. Mit USB Kabel den PC und den Player verbinden und am PC mit Browser bedienen.

Speicherkarten

Es können nur Speicherkarten mit der Bezeichnung „**HDHC CLASS 2**“ oder größer verwendet werden. Andere Speicherkarten entsprechen nicht der notwendigen Übertragungsgeschwindigkeit.



Anwendung

