


ACHTUNG:

- Das Massagegerät ist ein radionisches Gerät und kein Medizinprodukt im Sinne der Medizinprodukte - Richtlinie. Die Vitalisierung (Radionische Bewellung) unterstützt ausschließlich nur den Wellness - Prozess!
- Das Massagegerät ersetzt grundsätzlich keinesfalls die ärztliche Diagnose und Behandlung!
- Das Massagegerät darf nur vom medizinisch ausgebildeten Fachpersonal angewendet (Masseur) werden. Jede Zuwiderhandlung ist gefährlich und riskiert Schäden am Klienten.

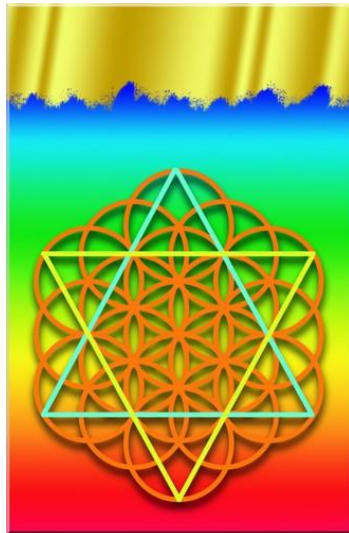

Disconder-Massage

mit Schall, Licht oder Skalarinformation.


Die Software DISCONDER wird nur im Zusammenhang mit dem *LernMaster* und *Massagegerät* vertrieben. Copyright © 2007 – 2014 Walter Thurner
Alte Allee 78a 81245 München www.walter-thurner.de / Informationstherapie

Das Programm „DISCONDER“ ist urheberrechtlich geschützt. Der Vertrieb dieser Software bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung, unbefugte Vervielfältigung ist strafbar.

Thurner Alte Allee 78 a 81245 München


Tel. +49 / 089 / 5803357 iba.thurner@t-online.de

www.walter-thurner.de




Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lieferumfang	3
Schallinformationstherapie Informationstherapie mit Fettzellen Informationstherapie mit Muskeln und Gelenken Informationstherapie mit Fußsohlen	4
Infrarot Informationstherapie	5
Skalarwellen	7
Frequenzen	9
Disconder Software Disconder Inhaltsbeschreibung Installation der Disconder-Software Disconder- Programm - Bedienung	15
Bedienungsanleitung Massagegerät	27
Sicherheitshinweise	28
Technisch Eigenschaften	29
CE- Zertifikat	29



Lieferumfang

- Massagegerät
- Schallkopf
- Spot – IR Licht
- Audiokabel
- DISCONDER Software (eingeschränkte Version)
- Beschreibung
- Schallschutz
- Skalare Spulen
- Optionen
 - Magnetische oder bifilare Informationsspulen
 - DISCONDER Software (Vollversion)



Schallinformationstherapie

Informationsbearbeitung mit Fettzellen

Mit Ultraschallfrequenzen (z.B. Frequenzen im Wasserstoffbereich) kann Fettgewebe abgebaut werden. Der Abbau des Fettgewebes durch Fettzellen - Entleerung mittels Wasserstofffrequenzen hört sich nicht gerade medizinisch glaubwürdig an. Die Praxis zeigt allerdings etwas anderes. Die Behandlungsdauer ist 2 x 20 Minuten mit einer Pause von 10 Minuten.

Schöne Haut und Haare, keine Cellulite und Orangenhaut sowie ein straffes Bindegewebe sind begehrte Schönheitsideale. Für die Schönheit legt sich mancher sogar unters Messer, für eine Fettabsaugung, Fettzellenentleerung, Fettweg-Spritze oder Bauchstraffung. Aber Schönheitsoperationen sind nicht ohne Risiko und nicht der beste Weg zur schlanken Figur und natürlicher Schönheit.

Das Massagegerät ist nicht dafür gedacht, einen größeren Bauchumfang oder sonstige größere Fettansammlungen zu reduzieren. Es ist eher als kosmetische Hilfe zu betrachten, wo Hautschönheiten wieder verbessert werden können. Außerdem ist die Wirkung nur möglich, wenn 3 Tage nach der Behandlung extrem wenig Kohlenhydrate gegessen werden.

Bei dieser Behandlungsart ist es notwendig, den Schallkopf beim Stecker „ULTRA“ anzuschließen.


Informationsbearbeitung mit Muskeln und Gelenken

Großflächige Behandlungen mit dem Schallkopf ersetzen aufwändige und zeitraubende Massagetätigkeit. Bei der Massage mit dem Schallkopf werden häufig nicht nur Muskelverspannungen aufgelöst, sondern es ist auch eine große Hilfe bei Wellnessbehandlungen.

Die meisten der heute verbreiteten Muskel- und Gelenkschmerzen sind meist die Ursache von verhärtetem Muskel. Des Weiteren sind auch Entzündungen eine Folge von Muskelverhärtungen. Schmerzen haben eine Aufgabe. Sie sind die Sprache des Körpers, um darauf hinzuweisen, dass wir im Begriff sind, ihn zu schädigen. Diese Nachrichten des Körpers können ursächlich und auf natürliche Weise behandelt werden.

Behandlungen dieser Art sollten unbedingt mit einem Arzt abgesprochen werden.

Bei dieser Behandlungsart ist es notwendig, den Schallkopf beim Stecker „AUDIO“ anzuschließen.




Informationsbearbeitung mit Fußsohlen:


Behandlung der Fußreflexzonen mit Schallwellen

Eine Behandlung des Fußreflexbereiches mit dem Schallkopf ist besonders angenehm und zielführend. Behandlungsdauer ist ca.10 min. pro Fuß.

Bei Fußreflexmassagen sind keine Nebenwirkungen bekannt und können sehr häufig durchgeführt werden.

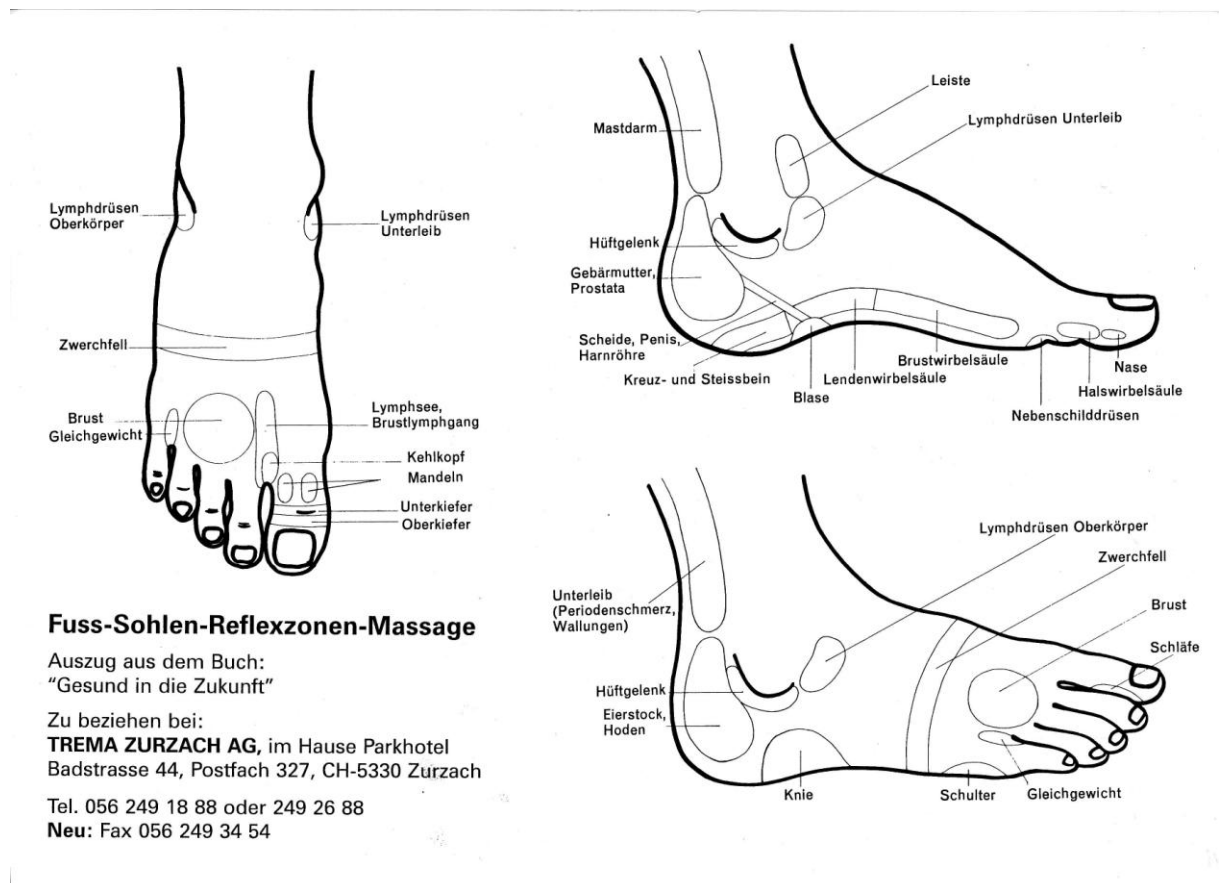

Bei dieser Behandlungsart ist es notwendig, den Schallkopf beim Stecker „AUDIO“ anzuschließen.



Infrarot- Bearbeitung

Eine Infrarot LED ist eine spezielle Leuchtdiode, die Licht in dem nahen infraroten Bereich emittiert. Als nahes Infrarot wird der Bereich des Spektrums bezeichnet, der sich in Richtung kleinere Wellenlänge an das sichtbare Licht anschließt. Dieser Infrarotbereich erstreckt sich von 780 nm bis 1mm und ist in folgende Gruppen eingeteilt:

1. IR- A von 780 nm bis 1,4 μm (Nahbereich)
2. IR- B von 1,4 μm bis 3 μm (kurzwelliger Bereich)
3. IR- C von 3 μm bis 8 μm ist der (mittlere IR)
4. Langwellige IR von 8 μm bis 15 μm (Keramikstrahler)
5. von 15 μm bis 1mm ist der Bereich der Terra Herzstrahlung
6. Rotlichtlampen erstrecken sich über den gesamten IR Bereich, also von 300 GHz bis 400 THz.

Die größte Strahlung wird im IR-A Bereich abgegeben und ist auch dementsprechend die effektivste Anwendung. Angewendet wird der Bereich von ungefähr 700 nm bis 1100 nm aufgrund der Transparenz. Je nach Wellenlänge unterscheidet sich auch die Eindringtiefe der Strahlung.


Nahes Infrarot dringt tief (von 2 bis 5mm) in und unter die Haut ein, während insbesondere mittlere IR-B bereits an der Oberfläche der Haut absorbiert wird.

Die Infrarot-Informationstherapie arbeitet im IR Spektrum von 900 nm bis 1100nm. Damit wird eine sehr gute Eindringtiefe erreicht und die Informationen (Frequenzen, Affirmationen usw.) können in den Körper gut übertragen werden.

Große Wirksamkeit wurde bei Kapillarproblemen beobachtet.

Unabhängig von der Behandlungsart, die angewendet wird, kann der Proband auch selbst mit dem Lichtspot gleichzeitig Problemzonen behandeln.

Bei dieser Infrarot - Behandlungsart ist es notwendig, den mitgelieferten Lichtspot beim Stecker „ZAPPER“ anzuschließen.



Elektrische Informationsfelder (Skalarwellen):

Elektrische Felder sind z.B. an Bäumen messbar. Insbesondere die Zellen von Lebewesen enthalten ein hohes elektrisches Feld an den Zellmembranen, die die Zelle außen abschließt. Aufgrund ihrer geringen Dicken ist die Feldstärke dort sehr hoch, mehrere Millionen Volt pro Meter. Elektrische Felder wurden bereits vor Jahrzenten zur Therapie angewandt.

Die Bedeutung elektrischer Vorgänge für das Leben erkennt man daran, dass z.B. aus glühendem Eisenstaub in KC-1 Lösung lebendige Zellen entstehen können. Das sog. Kolloide Zenta Potential hält Partikel gegenseitig auf Abstand. Dies ist eine Folge des elektrostatisch geladenen Teilchens. Virale „Partikel“ hingegen ballen sich zusammen, es fehlt Ladung. Dies kann man auch im Dunkelfilm-Mikroskop bei der sog. Gelbrollenbildung im Blut beobachten.


Schon im 18. Jahrhundert konnte man Bäume durch bespritzen mit Wasser das unter Hochspannung stand, besser wachsen lassen. Der Flüssigkeitskreislauf im Körper wird beeinflusst, das sind beim Menschen hauptsächlich das Blut und das Rückenmark, aber auch Zellwasser und die Lymph-Flüssigkeit. Selbst in Zähnen sind feine Dental Kanäle (bis zu 3 Mikrometer Durchmesser) vorhanden. Nach Gaston Naesens wirken Partikel im Blut als Krankheitserreger, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten. Fr. Clark fand heraus, dass Erreger durch bestimmte Resonanzfrequenzen abgetötet werden. Elektrische Ströme in Mäusen können Tumore zurückbilden, wobei die Erfolgsrate bei 60% liegt. Es existieren amerikanische Patente von Kaali, nach denen Viren, Bakterien und Pilze durch Anlegen eines elektrischen Stromes abtötbar sind. Es wird auch mehrfach darüber berichtet, dass Tumore bei Menschen durch Blitzschlag zurückgebildet wurden. Seit Tesla wurde dieser Effekt in Form von Hochspannungstechnik gezielt eingesetzt. Der amerikanische Arzt Rife fand sogar Frequenzen, die gegen Krebs wirken. Enderlein behauptet 1973, einen Krebserreger gefunden zu haben, demnach ist Krebs eine Infektionskrankheit. Der Einfluss elektronischer Felder ist störend, daher spricht man von Störfeldern. Röntgenstrahlung und Mikrowellen gehören dazu.

Die Skalarfelder kommen aus Flachspulen die in Liegematten ausgeliefert werden. Matten sind Optionen für eine Ganzkörperbehandlung. Die Spulen sind einzeln handhabbar und können auch in Betten über oder unter den Matratzen eingesetzt werden. Dieser Einsatz der Spulen ist besonders bei Schlafstörungen geeignet.

Als Spulenträger gibt es auch Liegematten. Es sind Matten, die wahlweise bestückt werden können. In einer Matte sind standardmäßig zwei Spulentaschen eingebaut. Die Mattentaschen können wahlweise bestückt werden.

- 1) 2 Skalar spulen
- 2) 2 Bifilarspulen
- 3) 1 Skalar spule und 1 Bifilar spule

Die Skalar- und Bifilar spulen arbeiten mit ganz schwachen Leistungen. Die Wirkung der Spulen liegt nicht in der Behandlung von skalaren Feldlinien, sondern in der




Verwendung von Informationen. Die skalaren und magnetischen Feldlinien sind nur Träger der Informationen.



Bei dieser Behandlungsart ist es notwendig die mitgelieferten Spulen bei den Steckern „ZAPPER“ und „AUDIO“ anzuschließen.

Magnetspulen und Bifilare Spulen sind eine **Option** und gehört nicht zum Standardumfang



Frequenzen

Im DISCONDER sind ca. 20 000 Frequenzen für Bearbeitung der Symptome vorhanden. Dazu kommen Informationen von Heilkräuter, Bachblüten, Globuli, Steinen usw. die vertont werden und die Anwendungen damit im akustischen Bereich als Information erweitern. Alle Frequenzen und Informationen sind auf allen Peripherien, wie z.B. mit Fernbehandlung, Schall, Magnetspulen, Bifilar spulen, IR-Licht, Violet-Ray, Akupunktur und Chimaster anwendbar.

Manuelle Erstellung:

Die Frequenzen oder Informationen können manuell oder automatisch erstellt werden. Für die manuelle Erstellung sind Datenbanken mit einer übersichtlichen Darstellung vorhanden. Bei der manuellen Bearbeitung muss bei dem Umgang mit Symptomen, Bachblüten, Globuli usw. eine gute Voraussetzung erfüllt sein.

Automatische Erstellung:

Bei der automatischen Erstellung sind keine med. Fachkenntnisse notwendig. Die Auswahl beruht ausschließlich durch den autom. Dialog mit dem Bewusstsein. Für die Auswahl sind 2 Möglichkeiten vorgesehen.

1. Tonbehandlung (Einzelanwendung) oder
2. Tonbehandlung interaktiv.


Tonbehandlung:

Mit der Tonbehandlung wird aus 6 Frequenzgruppen eine Symptombehandlung automatisch mittels Bewusstseinsdialog ausgewählt und für die therapeutische Behandlung bereitgestellt.

Tonbehandlung interaktiv:

Die interaktive Tonbehandlung wählt mittels Bewusstseinsdialog aus allen 6 Frequenzgruppen je 5 Anwendungen aus. Die Frequenzgruppen sind wie folgt aufgebaut

- Extramusik
- Frequenz_1
- Frequenz_2
- Frequenz_3
- Frequenz_4
- Zahlen.



Die für die Anwendung ermittelten Frequenzen werden auf einer Liste aufgelistet.

Extramusik

Bewertung: 1

Name: Jupiter

Grundwelle: Jupiter.wav

Bewertung: 1

Name: Ladakh-Uranus

Grundwelle: ladakh-16 Uranus.wav

Bewertung: 1

Name: Magen

Grundwelle: Magen.wav

Bewertung: 1

Name: 6-Drittes-Auge-Chakra

Grundwelle: 6-Dritte-Auge-Chakra.wav

Bewertung: 1

Name: Herz

Grundwelle: Herz.wav


Frequenz 1

Bewertung: 1

Name: Aconite

Grundwelle: 3347\$5611\$2791

Bewertung: 1



Name: Acidosis

Grundwelle: 10000\$880\$802\$787\$776\$727\$146\$20

Bewertung: 1

Name: Arthritis_general

Grundwelle:

10000\$5000\$2720\$1664\$1550\$1500\$962\$880\$802\$800\$787\$776\$766\$727\$688\$683\$650\$60

Bewertung: 1

Name: Biliary_headache

Grundwelle: 8,5\$3,5

Bewertung: 1

Name: Allergy

Grundwelle: 10000\$7344\$5000\$1550\$1234\$740\$880\$835\$787\$727\$500\$330\$160\$30\$3

Frequenz 2

Bewertung: 13

Name: Alkaptonuria

Grundwelle: 0,07\$0,40\$7,50\$55,00\$96,50\$376,29\$426,90\$571,00\$822,00\$937,41

Bewertung: 7

Name: Arachnoid Cysts

Grundwelle: 0,16\$0,60\$0,90\$2,50\$3,00\$125,09\$225,33\$344,50\$490,56\$807,22


Bewertung: 6

Name: Bunyaviridae Infections

Grundwelle: 0,26\$0,65\$5,12\$7,00\$42,50\$200,00\$458,50\$515,15\$683,00\$712,42

Bewertung: 6

Name: Ankyloglossia



Grundwelle: 0,08\$0,78\$5,81\$67,50\$350,00\$475,00\$527,00\$665,34\$742,00\$985,67

Bewertung: 5

Name: Alexander Disease

Grundwelle: 0,14\$0,78\$2,50\$97,50\$357,77\$475,05\$527,00\$657,11\$749,00\$987,23

Frequenz 3

Bewertung: 18

Name: Abortus

Grundwelle: 10000\$5000

Bewertung: 12

Name: Aterienanreger

Grundwelle: 727\$787\$800\$880

Bewertung: 12

Name: Adenoide Wucherungen

Grundwelle: 2128\$880\$787\$727\$20

Bewertung: 12

Name: Abführmittel


Grundwelle: 20\$727\$787\$800\$880\$802

Bewertung: 11

Name: Adenexitis

Grundwelle: 522\$572\$3343\$3833\$5312\$440\$441

Frequenz 4



Bewertung: 7

Name: Gestaltungskraft

Grundwelle: 183,58

Bewertung: 5

Name: Herz-Kreislauf

Grundwelle: 933

Bewertung: 4

Name: Gouveneur-Meridian

Grundwelle: 53,3

Bewertung: 4

Name: Gallenblase

Grundwelle: 510

Bewertung: 4

Name: Lunge

Grundwelle: 2020

Bewertung: 4

Name: Dreifach-Erwärmer

Grundwelle: 988,5


Zahl

Bewertung: 13

Name: Aerosinusitis

Grundwelle: 514854237

Bewertung: 11



Name: Akromegalie

Grundwelle: 1854321

Bewertung: 11

Name: Alkoholismus

Grundwelle: 148543292

Bewertung: 10

Name: Aktinomykose der Haut

Grundwelle: 148542156


Bewertung: 9

Name: Apoplexie des Eierstocks

Grundwelle: 1238543


Die in der Liste eingetragenen Symptome mit den zugehörigen Frequenzen werden in einer *.wav – Datei zur Anwendung bereitgestellt. Diese umfangreiche Behandlungsart kann in allen im System erwähnten Peripherien angewendet werden.

Alle Forschungsberichte sind nur Beobachtungen, versprechen nichts, bei gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich an Ihren Arzt.



Disconder Software

Eingeschränkte Version

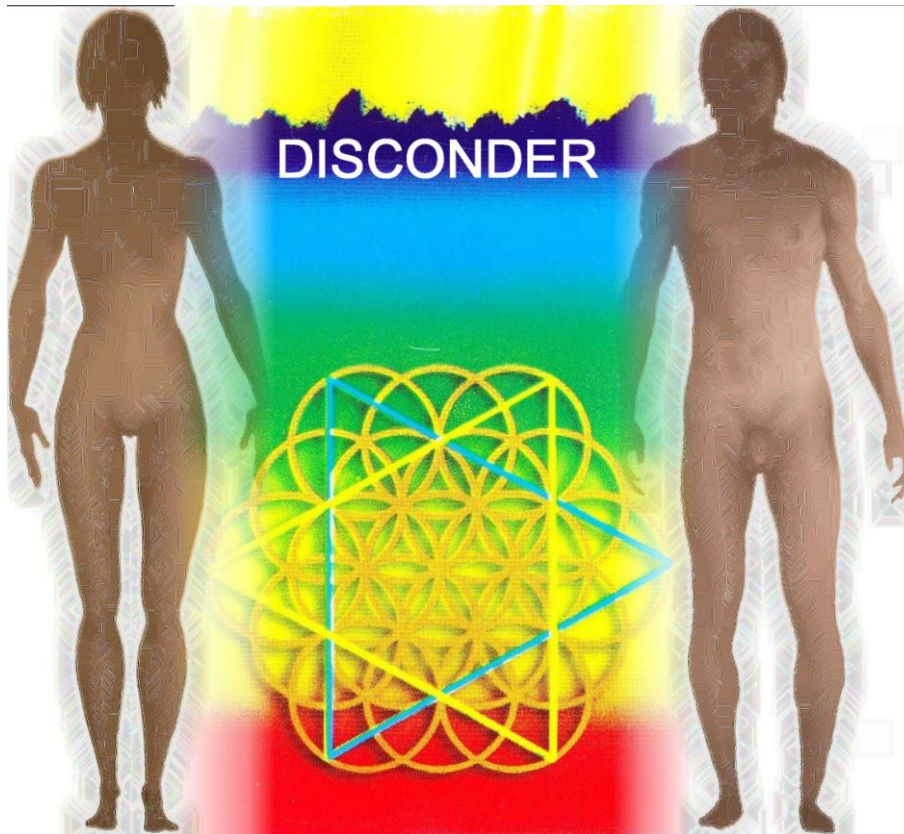

Diese Software wird nur im Zusammenhang mit dem **Massagegerät** vertrieben.


Copyright © 2007 – 2013 Walter Thurner

Alte Allee 78a

81245 München

www.walter-thurner.de

Dieses Programm ist urheberrechtlich geschützt. Der Vertrieb dieser Software bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung, unbefugte Vervielfältigung ist strafbar.



Inhaltsbeschreibung und Bedienanleitung der Disconder **Hilfe**

Beschreibung des Disconder Systems

Einführung:

Anwendungsmöglichkeiten

Sprache:

Affirmationen/ Mentaltraining:

Gehirnwellen-Frequenzen:

Musiktitel:

Frequenztherapie

Die Quinte

Melodien und Klänge

Phasenverschiebung

Verhältnisse im goldenen Schnitt

Die Energiemeridiane im menschlichen Körper:

Dreiklang

Installation der Disconder-Software:

Systemvoraussetzungen:

Vorgehensweise:

Bedienung des Disconder-Programms:

Schritt 1: Auswahl einer Gehirnfrequenz:

Schritt 2: Eingabequelle auswählen

Auswahl einer WAV – Datei:

Auswahl einer MP3-Datei:

Auswahl aus bestehenden Melodien und Klängen:

Auswahl über Tonfrequenzgenerierung

Auswahl über Ton / Sprach-Aufnahme

Schritt 3: Ausgabedatei erzeugen:

Der Lernmaster

Bei jeder Anwendung des LearnMasters:

Hörprogramme die nicht als Quelldatei erkannt werden

Löschen von Titeln:

Beschreibung des Gerätes auf der Sensorseite:

Batterie laden

Laden über den Netzstecker:

Laden über den Computer

Musiktitel hören

Sprachen lernen:

Meditation:


Affirmation:

Sicherheitshinweise

Technische Eigenschaften:

Ergänzungen und Tipps

FreeRip Umwandlungsprogramm



Titel am LearnMaster ordnen:

Anwendung vom LearnMaster mit Kopfhörer:

Einstellen der Wiederholungsfunktion für einen speziellen Titel

Allergie

Schwingungstherapie mit dem Lernmaster.

Musiktherapie

Klangtherapie

Klangschalenterapie

Frequenztherapie

Bioresonanz

Tontherapie

Infrafrequenzen



Installation der Disconder-Software

Systemvoraussetzungen:

- Windows 2000: SP 4
- Windows XP: SP 2 und eventuell bei alten Systemen WindowsInstaller-KB893803-v.. SP und KB Bausteine auf Service CD
- Vista, System7, System8 keine Servicebausteine notwendig.


Vorgehensweise


- Legen Sie die Installations-CD „Disconder“ in das CD-ROM – Laufwerk ein.
- Klicken Sie auf der CD die Datei „SetupDisconder.exe“ an.
Die Installation überprüft zunächst, ob die Microsoft Komponente „.NET“ bereits auf Ihrem Computer installiert ist. Falls nein wird diese zunächst installiert. Sollte diese Installation misslingen, fehlt auf Ihrem Computer der Windows Installer 2.0 oder höher. Diesen können Sie von den Microsoft-Support-Seiten im Internet downloaden, oder wenden Sie sich an Ihren PC-Service-Support (sind auch auf der DVD unter „Support/Service“ geladen).
- Wählen Sie ein Installationsverzeichnis: z.B. „C:\Programme\Disconder“:
Falls das Verzeichnis nicht existiert, können Sie es so anlegen:

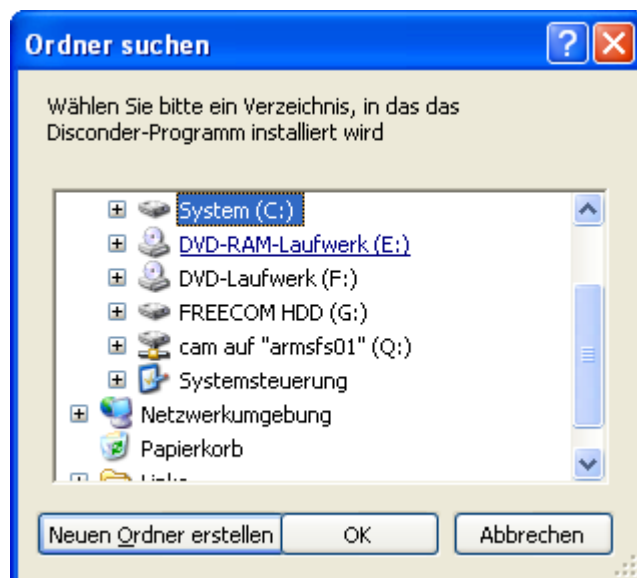


Klicken Sie das gewünschte Laufwerk und anschließend das Verzeichnis an, in dem das Disconder-Verzeichnis angelegt werden soll und wählen Sie dann die Option „Neuen Ordner erstellen“. Tippen Sie „Disconder“ und klicken Sie anschließend „OK“.

- Das Ende der Installation wird angezeigt mit:
-

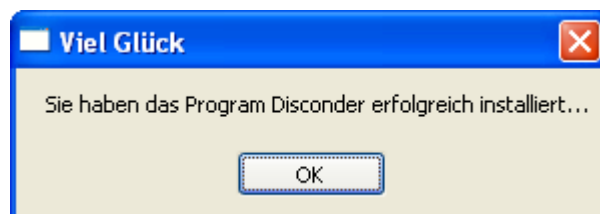

Sie finden auf Ihrem Desktop nun ein Icon für den Start: , sowie in Ihrem Programm-Menü einen Eintrag „Disconder“ mit den Optionen: „DOKU“ und „Start.“




DISCONDER Software Bedienungsablauf für autom. Ablauf.


Mit der DISCONDER Software wird ein Physisches und psychisches Porträt des Klienten erstellt. Nach diesem Porträt wird vom DISCONDER eine Informationsbehandlung aufgebaut. Disconder mit automatischem Ablauf ermöglicht in nur 7 Bedienungsschritten eine kompletten Erstellung von individueller und persönlicher Informationsbehandlung. Die Ergebnisse der Informationsbehandlung sind für folgende Behandlungsmethoden wie


- Bewusstseinstrainer und Lernmaster
- Schallbehandlung
- IR-Licht
- Kozyrevspiegel und
- Skalar matten einsetzbar.

1. Automatisch anwählen

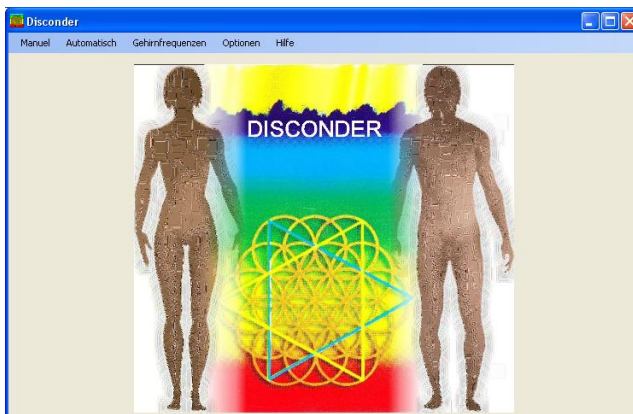

2. Das eigene Personenfoto auswählen (vorher ein Foto machen)

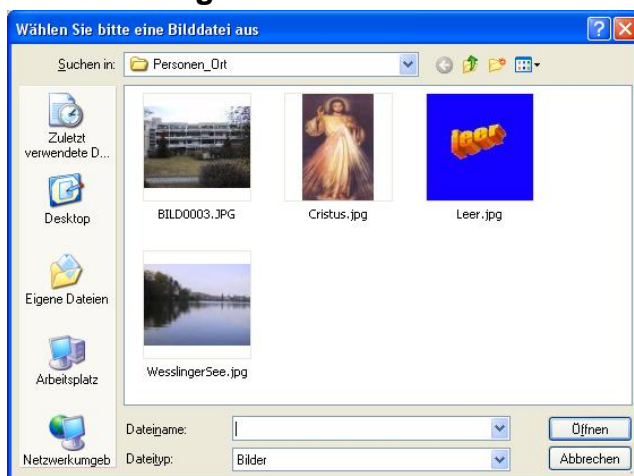



3. Individuelle Fragen anwählen


In der Gesprächsmaske stehen 24 Gruppen zur Auswahl. Es ist den Anwender überlassen, ob alle Informationsgruppen zur Bearbeitung erwünscht sind. Mit den Auswahlhäkchen kann der Bearbeitungsumfang gesteuert werden.

Die Eintragung ist kein muss.

4. Start Analyse anwählen

Mit den Individuellen Fragen kann der Anwender mit gezielten Anliegen oder Fragen in die Auswertung einwirken.

Die Eintragung ist kein muss.



5. Individuelle Fragen anwählen

Wählen Sie bitte Gesprächsgruppen aus

- Allg. Symtome_1
- Allg. Symtome_2
- Melodien
- Symtome nach Reif
- Vitalfrequenzen
- Zahlen

Individuelle Fragen

Mit der Menge der Gruppenauswahl wird die Behandlungszeit gesteuert. Alle 6 Gruppen ausgewählt ergibt eine Behandlungszeit von 5 Stunden. Behandlungen von 5 Stunden sind aber nur mit dem Bewusstseinstrainer oder das Laden von Globuli sinnvoll. Für Behandlungen mit IR-Licht, Schall oder Skalar-Matten wird eine Auswahl von nur einer Gruppe empfohlen.

Die Eintragung ist kein muss.

6. Start Analyse anwählen

Bitte stellen Sie zu jeder gewählten Gruppe eine individuelle Frage (Bewertung)

Allg. Symtome_1
Welche Frequenz brauche ich für den Körper und Geist zur Norm

Allg. Symtome_2
Welche Frequenz brauche ich den Körper und Geist zur Norm

Melodien
Welche Frequenz brauche ich den Körper und Geist zur Norm

Symtome nach Reif
Welche Frequenz brauche ich den Körper und Geist zur Norm

Vitalfrequenzen
Welche Frequenz brauche ich den Körper und Geist zur Norm


Zahlen
Welche Frequenz brauche ich den Körper und Geist zur Norm

Einstellungen speichern

Start Analyse

Mit den Individuellen Fragen kann der Anwender wie beim Gespräch mit gezielten Anliegen oder Fragen in die Auswertung der Frequenzen einwirken.

Die Eintragung ist kein muss.




7. Mit Frequenzausgabe die Informationen auf den externen Player übertragen



Mit der Taste „**Frequenzausgabe**“ wird direkt per „HOP und DROP“ die vom DISCONDER erstellte Informationsdatei (WAV-Datei) auf den externen Player zu Behandlung übertragen. Außer den Einschaltknopf sind am Player keine weiteren Bedienungen notwendig.

Mit der Taste „**Textprotokoll**“ kann eine Inhaltsliste über die erstellte Informationsbehandlung am Drucker aufgelistet werden. Den Aufbau der Liste entnehmen Sie aus der Beschreibung „DISCONDER Ursachenerkennung“ Seite 30 und DISCONDER Frequenzen Seite 18.



DISCONDER Software Bedienungsablauf für manuellen Ablauf.

Wenn zu den autom. Ablauf noch weitere spezielle Informationsverarbeitungen notwendig sind, können die vom Anwender gewünschten Vorgänge manuell erstellt und in die Anwendungsdatei am Player übertragen werden. Neben der autom. Anwendung sind auch zusätzliche manuelle Anwendungen gleichzeitig möglich.

Aus der WAV – Datei:

Bearbeitung von bereits vorhandenen WAV – Dateien. Das WAVE-Dateiformat wurde von Microsoft und IBM zur verlustfreien Speicherung von Audiodateien entwickelt. Aufgrund der großen Dateigröße wird dieses Format im kommerziellen Umfeld heute kaum verwendet. Es eignet sich jedoch wegen seines unverfälschten und ungekürzten Aufbaus sehr gut zum Modulieren, Wobbeln und Mischen und die Ausgabe über den Audioport ist als Funktionsgenerator nutzbar. Alle anderen Musikformate sind für die Verarbeitung mit dem Disconder nicht brauchbar.

Nach der Auswahl wird ein Browser – Menü vorgelegt. In diesem Browser- Menü wählen Sie ein Verzeichnis aus und danach die zu verarbeitende WAV - Datei.

Aus einem WAV – Verzeichnis

Bearbeitung von bereits Vorhandenen Verzeichnissen mit WAV – Dateien. Wenn mehrere WAV – Dateien zu bearbeiten sind, könne alle in ein eigens kreierte Verzeichnis gelegt und zeitsparen alle auf einmal bearbeitet werden.


Nach der Auswahl wird ein Browser – Menü vorgelegt. In diesem Browser- Menü wählen Sie Ihr vorbereitetes Verzeichnis aus und danach werden alle im Verzeichnis liegende WAV – Dateien bearbeitet.

Aus einer MP3 – Datei:

Die meisten Musik- und Hörsysteme werden am Markt in MP3 – Dateien angeboten. MP3 – Dateien sind wegen der extremen Kürzung für eine technische Weiterbearbeitung nicht geeignet. Alles nicht Hörbare wird im MP3-Format entfernt, aber gerade auf die nichthörbaren Bereiche kommt es im Disconder im Besonderen an. Um auch MP3 – Dateien zu verarbeiten, werden alle MP3 – Dateien vom Disconder erst in eine WAV - Datei gewandelt. Nach der Auswahl wird ein Browser – Menü vorgelegt. In diesem Browser- Menü wählen Sie ein Verzeichnis mit MP3 –Dateien aus und danach die zu verarbeitende MP3 - Datei.

Vordefinierte Melodien und Klänge:

Vordefinierte Melodien und Klänge sind kurze Musikstücke aus mehreren Frequenzen. Diese Melodien werden in 2 Hauptgruppen aufgeteilt, in Melodien die aus Bil-



dern, und in Melodien die aus Instrumenten generiert wurden. Folgende Melodien wurden aus Bildern generiert

- Organe
- Bachblüten
- Farben
- Globuli
- Pflanzen
- Edelsteine

Die Bilder sind Fotos die in einem speziellen Verfahren vertont wurden. Anschließend wurde dieser Ton mit einer original meditativen tibetanischen Klangschale moduliert und in den ausgewiesenen Verzeichnissen zu Auswahl abgelegt.

Melodien aus Instrumenten sind

- Chakren
- Nährstoffe
- Klangschalen

In einem speziellen Verfahren wurden Resonanzen zu den genannten Medien aufgebaut. Anschließend wurden diese Resonanztöne mit einer original meditativen tibetanischen Klangschale moduliert und in den ausgewiesenen Verzeichnissen zur Auswahl abgelegt.

Aufgerufen werden diese Melodiegruppen durch Auswahl der Gruppen und anschließend durch Auswahl der Melodien in den Gruppen.


Tonfrequenzen generieren:

Tonfrequenzen sind in 3 Hauptgruppen aufgeteilt

- Tonleiter,
- Fest definierte Frequenzen und
- manuelle Eingabe.

Die Bearbeitung der **Tonleiter** bedarf Grundkenntnisse in der Musik und Grundkenntnisse des natürlichen logarithmischen Aufbaus in der Zahl „e“ nach Euler. Wegen der umfangreichen Ausführung dieser Zusammenhänge wird an dieser Stelle auf die weitere Erläuterung verzichtet und ausdrücklich auf die Hilfebeschreibung verwiesen. Da viele Vorteile durch diese Anwendung beobachtet wurden, lohnt sich die Einarbeitung in diese Grundkenntnisse.

Die Bearbeitung der **fest definierten Frequenzen** resultieren aus Erfahrungen des US – Amerikaners Rive und vieler Heilpraktiker.



Manuell kann jede beliebige Frequenz eingegeben und angewendet werden.

Alle 3 Eingabemöglichkeiten können als Grundton oder als Quinte (harmonisch) betrieben werden. Bei Angabe der Quinte wird die entsprechende Frequenz automatisch berechnet. Mit der Dauer kann die Länge der Wiedergabe festgelegt werden. Es ist wichtig darauf zu achten, dass vor allem die „**pathologischen Frequenzen**“ aus mehreren Frequenzen (bis zu 20) bestehen. Wenn die Dauer erhöht wird, gilt das für jede einzelne Frequenz und es kommt unter Umständen zu ungewollt langen Laufzeiten. Die Lautstärke ist optimal eingestellt und sollte nur bei gezielten Anwendungen verändert werden. Über „Generieren“ wird die Auswahl abgeschlossen.

Aufgerufen werden diese Frequenzgruppen durch Auswahl der Gruppen und anschließend durch Auswahl der Frequenzen in den Gruppen. Bei Manuell ist keine Gruppenangabe erforderlich.

Ton / Sprache aufnehmen:

Ton / Sprache ist der Rekorder in diesem System. Es dient hauptsächlich zum Aufnehmen von Affirmationen, Behebung von Konflikten, Ängsten, Glaubenssätze sowie Beeinflussung durch Erlebnisse usw. Der Klient bespricht mit seiner eigenen Sprache eine Rekorder – Datei.

Mit der Wiederholung kann die Häufigkeit der Wiedergabe festgelegt werden.

Die Aufnahme wird über „**START**“ begonnen und über „**STOP**“ beendet. Über „**Start – Wiedergeben**“ kann die Aufnahme vor der Weiterverarbeitung kontrolliert werden.

Ausgabe erzeugen:

Mit **Ausgabe erzeugen** wird die Ausgabeart (ein oder zwei Kanal), die Gehirnfrequenz und die zu verarbeitende WAV- Datei angezeigt. Mit der Wiederholung kann die Häufigkeit der Wiedergabe festgelegt werden. Mit der „Ausgabedatei“ wird das Verzeichnis und der Dateiname für die Ausgabe angegeben. Über „**MIXEN**“ wird die Verarbeitung und das Anlegen der Datei gestartet.


Manuele - Schnellanleitung:

Schritt 1: Gehirnfrequenz auf Alpha oder Theta einstellen

- Weiter

(Alpha: Lernen, Theta: Meditation, tiefes Lernen)

Schritt 2: Eingabequelle auswählen und



Schritt 3 Ausgabe erzeugen:

- Weiter

-vordefinierte Melodien und Klänge: Auswahl: Heilpflanzen, Bachblüten, Chakren, Farben, Globoli, Klangschalen, Nährstoffe, Planeten, Steine

Wiederholungen: z. B. 108

Ausgabedatei: z. B. Test.wav -Mixen

-Tonfrequenz generieren: Vitalisierung über Grundfrequenz: Vitalisierung von Organen A-Z

Auswahl: nur Grundton – Generieren

Wiederholungen z. B. 108

Ausgabedatei: z. B. Test.wav - Mixen

-Ton/Sprache aufnehmen: Sprache aufnehmen über Mikrofon (an den Computer anschließen) –Start Aufnahme – Stop – Übernehmen

Wiederholungen: z. B. 108

Ausgabedatei wählen z. B. Test.wav -Mixen

Neu generierte Datei über ein USBN-Kabel auf den LearnMaster (Music) übertragen.

Disconder Bedienungs Anleitung:


siehe auch in der „Hilfe - Beschreibung“ im Disconder Programm.

Bedienungsanleitung Massagegerät

Das Massagegerät hat auf der Vorderseite drei Stecker denen unterschiedliche Anwendungen und Gräte zugeordnet werden können.

AUDIO Stecker

- Schallkopf für die Behandlungsart „Informationstherapie mit Muskeln und Gelenken“
- Schallkopf für die Behandlungsart „Informationstherapie mit Fußsohlen“



- Skalar oder Bifilarspulen für die Behandlungsart „skalare und bifilare Informationsfelder“ (Option)

ZAPPER Stecker

- Lichtspot für die Behandlungsart „Infrarot Informationstherapie“
- Skalare oder Bifilar spulen für die Behandlungsart „skalare und bifilare Informationsfelder“ (Option)

ULTRA Stecker



- Schallkopf für die Behandlungsart „ Informationstherapie mit Fettzellen“


UMSCHALTER








Das Massagegerät verfügt über 2 Betriebszustände: (Umschalter ist auf der Rückseite des Gerätes).

- Interner Betrieb: Im Gerät ist ein Player vorhanden, der für zwei Ausgänge „AUDIO“ und „ZAPPER“ eine einheitliche Frequenz (Melodie) ausgibt.
- Externer Betrieb: Wenn der Umschalter auf EXT. steht und das Massagegerät mit einem beigegefügt Audiokabel mit dem PC verbunden ist, kann das Massagegerät mit den aus dem DISCONDER generierten Audiosignalen am PC betrieben werden.
- Die Bandbreite der Behandlungsmöglichkeit ist damit extrem. Der Umgang mit der Disconder - Software ist in der Hilfe Beschreibung festgehalten.

Sicherheitshinweise für das Massagegerät

	Das Gerät stellt für den Anwender keinerlei Gefahr dar, da eine innere Stromquelle mit niedriger Spannung (12V) verwendet und eine CE Zertifizierung nach med. Standard hat.
	Das Gerät darf nicht an Anwender benutzt werden, bei denen ein elektronischer Apparat (z.B. Herzschrittmacher) implantiert wurde. Ebenso darf das Gerät nicht bei Personen angewendet werden, die an Unverträglichkeiten gegenüber elektrischen Strom leiden.



	Es ist verboten. Das Gerät in der Direktprojektion des Herzens vom vorne zu verwenden.
	Während der Anwendung darf die Person nicht an ein wie auch immer geratenes Hochfrequenzstromgerät angeschlossen werden. (Verbrennungsgefahr) Außerdem ist in einem solchen Fall die Zerstörung des Massagegerätes möglich.
	Ist in der Nähe ein therapeutisches Kurzwellen-Gerät, ein Mikrowellen-Gerät oder Handy in Betrieb, kann dies beim Massagegerät zur Instabilität der Ausgangsparameter führen.
	Das Gerät enthält zerbrechliche Elemente. Schützen Sie das Massagegerät vor Stößen.
	Das Massagegerät ist nicht wasserdicht, schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
	Alle Funktionsstörungen werden durch den Hersteller behoben.
	Entsorgung: Verpackung Sämtliche Verpackungsmaterialien sind für die Umwelt unschädlich und können wiederverwendet werden. Massagegerät Getrennte Entsorgung, das Massagegerät ist ein elektronisches Gerät und muss zum Elektronikschrott.

Technisch Eigenschaften des Massagegerätes


Stromversorgung 230 V / 50 Hz

Audio - Eingangspegel max. 2V pp

Eingangswiderstand 22 KOhm

Frequenzgang 10Hz - 100 KHz (-3dB)

Verstärkung 34 dB



C€ Certifikat Massagegerät


DIN EN 6060_1-1-2, VDE 0750-1-2-2007-12 Medizinische elektrische Geräte- Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Ergänzungsnorm: Elektroische Verträglichkeit – Anforderungen und Prüfungen (IEC 60601-1-2-2007, modifiziert); EN 60601-1-2:2007

Ausgestellt am 20.04.2013 von Schwille Elektronik 85551 Kirchheim / München

Anwendungen



Massagegerät mit IR-Licht



Massagegerät mit Schallglocke



Skalarspulen für das Massagegerät